


Pilotstudie: VIROBUSTER® im niedergelassenen Bereich

Untersuchung

Im Rahmen einer Pilotstudie mit 15 Arztpraxen im niedergelassenen Bereich wurde die Keimbelastung der Luft vor und nach Einsatz von VIROBUSTER® STERITUBE oder STERIBASE 300 PLUS gemessen.³

Effizienz von VIROBUSTER® im medizinischen Bereich³

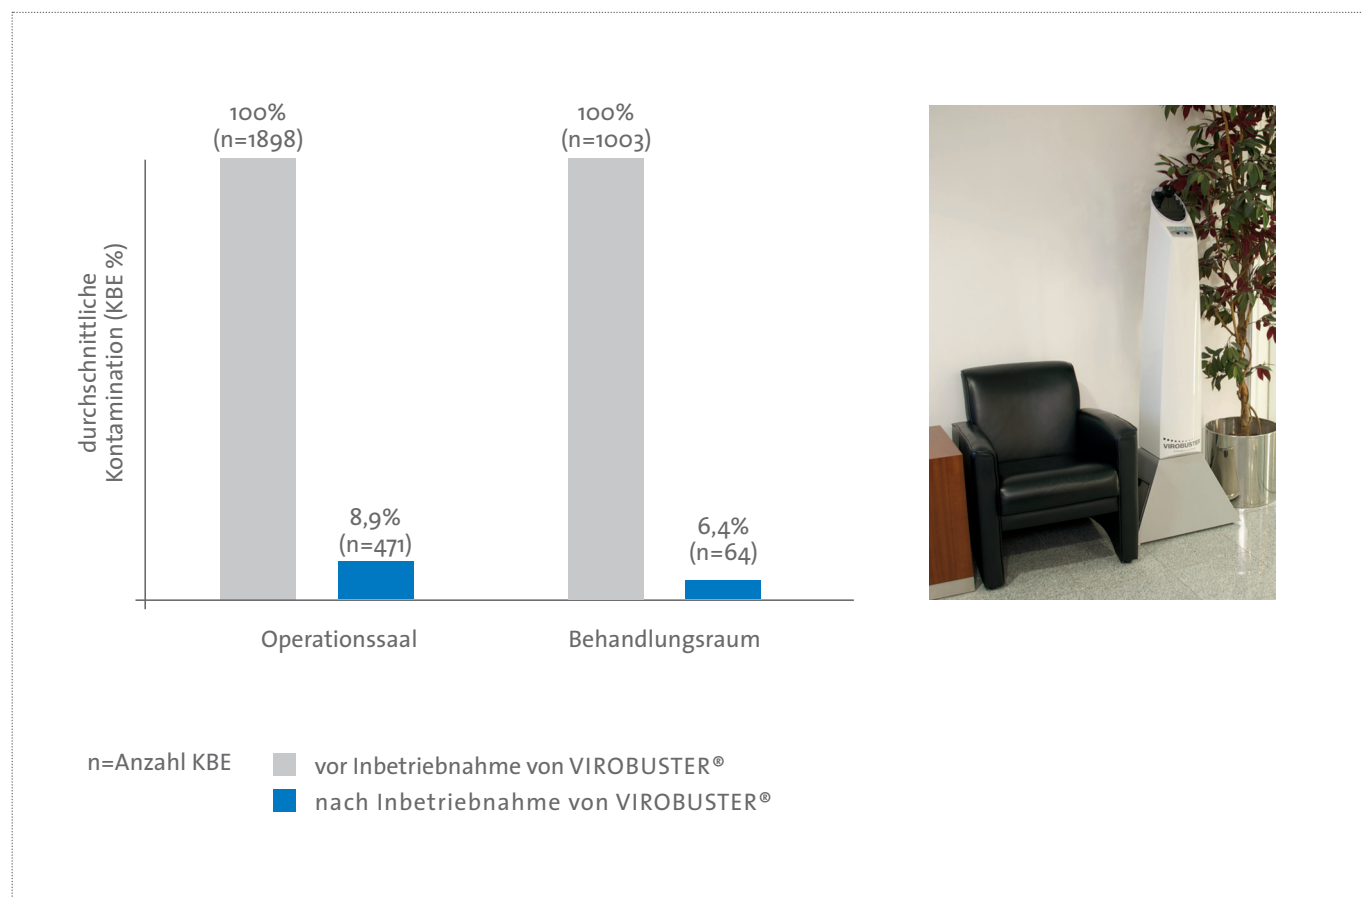

³ Messungen durch Zentrum für Mykologie, Köln (VIROBUSTER, data on file).

Ergebnis:

Die Konzentration luftübertragener Keime wurde um 91,1 % bzw. 93,6 % reduziert.